



DTX Studio™ Clinic

バージョン 3.1

取扱説明書

目次

はじめに	5
免責事項	5
デバイスの概要	5
使用目的	5
用途／適応	5
対象ユーザーおよび対象患者のターゲットグループ	5
他のデバイスとの必要な互換性	6
口腔内センサー	6
口腔内カメラ	6
口腔内スキャン	6
ソフトウェア	6
測定機能を備えたデバイス	6
禁忌	6
サイバーセキュリティ	6
互換性	6
相互運用性	6
耐用年数	6
パフォーマンスの要件および制限	7
臨床的利点と望ましくない副作用	7
施設およびトレーニング	7
重大な事故に関する通知	7
医療従事者用	7
システム要件	7
ソフトウェアのインストール	7
取り扱い手順	7
警告および注意事項	8
警告	8
注意事項	9
システム要件	10
オペレーティングシステム	10
機器	10
開始	11
DTX Studio™ Clinicの起動	11
作業領域の解説	11
通知領域の解説	11

設定の調整	12
DTX Studio™ Clinicのデフォルト設定の調整	12
設定のインポートまたはエクスポート	12
言語と日付/時刻形式の変更	12
DICOM準拠の設定の調整	12
デフォルトのイメージフィルタの設定	13
口腔内画像の自動回転の無効化	13
レベルとウィンドウの値の自動設定の無効化	13
DTX Studio Coreへの接続	13
アクションウィンドウへのアプリケーションの追加	14
プラクティスマネージメントシステム (PMS) 統合の有効化	14
DTX Studio™ ClinicへのTWAIN機器の追加	14
使用可能なすべてのショートカットの表示	15
DTX Studio™ Clinicの終了	15
ソフトウェアを終了する	15
主な機能の概要	16
患者記録	17
新しい患者記録の作成	17
患者記録の管理	17
プライバシーオプションの管理	17
患者記録の検索とソート	18
患者リストのソート	18
患者の検索	18
患者記録のエクスポート	18
患者記録のエクスポート	18
を介した患者データの共有DTX Studio Go	19
3Shape Dental Desktopソフトウェアからのインポート	20
スキャンのリクエスト	21
スキャンのスケジュール	21
スキャンリクエストの検索とソート	21
スキャンリクエストリストのソート	21
スキャンリクエストの検索	21
スキャンデジタルワークフロー	22
スキャンデジタルワークフローの定義	22
スキャンデジタルワークフローの適用	22

スキャンの実行	23
予定されているスキャンの実行	23
即時スキャンの実行	23
口腔内センサーまたはPSP機器によるガイドあり取得	23
口腔内センサーまたはPSP機器によるガイドなし取得	24
口腔内カメラによるガイドあり画像取得	25
口腔内カメラによるガイドなし画像取得	25
口腔内スキャン	25
3Shape TRIOS®スキャナー	25
KaVoスキャナーとMeditスキャナー	26
口腔内のスキャンデータを取得する	26
スキャン症例を再度開く	26
解析または治療計画	27
患者モジュールの解説(以前の診断モジュール)	27
患者メニューの使用	28
メニューオプション	28
診断用歯式チャート	28
歯式チャートの編集	29
解析データ	29
データのインポート	30
3Dスキャンのインポート	30
デンタルスキャンのインポート	30
フェイススキャンのインポート	30
2D画像のインポート	31
3Dおよびデンタルスキャンビューアの背景の設定	31
デフォルトの画像ズームレベルの設定	31
マウスの操作	32
ワークスペース	33
ワークスペースのカスタマイズ	35
SmartFocus™で関連する歯の情報をすべて表示	35
スマートレイアウトでビューをカスタマイズ	36
スマートフュージョンにおけるデンタルスキャンのアライメント	36
サムネイルバーの使用	36
解析所見の追加	37
SmartPanel™ 歯式チャート	37
歯のワークスペースでの歯の回転軸の調整	38
3Dボリュームのクリッピング	38
ワークスペースでの歯科用口腔内カメラの使用	38
ツール	39
レポート	43
レポートの作成	43
カスタムのプラクティスロゴの追加	43
DTX Studio Implantの起動	44
DTX Studio™ ClinicとDTX Studio Implantの接続	44
DTX Studio Implantの起動	44
オーダー	44
補綴修復または手術計画のオーダー	44

はじめに

免責事項

この製品は、包括的なコンセプトの一部であり、ノーベルバイオケア(以下「当社」とする)の取扱説明書に従い、適合する専用の製品との組み合わせでのみ使用できます。他社製品にノーベルバイオケアの製品を組み合わせさせて推奨されない方法で使用した場合、ノーベルバイオケアのいかなる保証も、その他のいかなる義務も、明示／黙示を問わず無効になります。ノーベルバイオケアの製品を使用する際には、いかなる製品についても、それが特定の患者およびその状況に適合するかどうかを判断しなければなりません。ノーベルバイオケアは、ノーベルバイオケア製品の使用において、専門的な判断または治療におけるエラーが原因となって生じるか、またはそれらに関係して生じる、直接的、間接的、懲罰的、またはその他のどのような損害の責任も明示／黙示を問わず負わないものとします。ユーザーは、この製品に関する最新の開発動向およびその適用について、定期的に学ぶ義務を負っています。ユーザーは、不明な点がある場合には、当社に連絡する必要があります。この製品の利用についてはユーザーの監督下で行われるため、ユーザーの責任になります。当社は、製品の加工および外科への適用が原因で生じる損害に対して一切の責任を負いません。本取扱説明書で言及している製品のうち、国や地域によっては認可状況の関係で、一部の製品が発売されていない場合があります。ご了承ください。

DTX Studio™ Clinicをご使用になる前に、取扱説明書をお読みになり、今後必要になる時に備えて保管しておいてください。本書で取り上げる情報は、すぐに使えるように簡潔に示されています。

デバイスの概要

DTX Studio™ Clinicは、歯科、頭蓋顎顔面および関連する状態の治療を目的として2Dおよび3Dの画像データをタイムリーに分析するために使用する、歯科医師向けのソフトウェアインターフェースです。DTX Studio™ Clinicは、さまざまなデバイス(口内法X線撮影装置、(CB)CTスキャナー、口腔内スキャナー、口腔内および口腔外カメラなど)からの画像データを表示します。

使用目的

このソフトウェアの目的は、歯科および頭蓋顎顔面の治療の解析プロセスと治療計画をサポートすることです。

用途／適応

DTX Studio™ Clinicは、歯科および頭蓋顎顔面の画像情報の取得、管理、転送、および分析用のソフトウェアプログラムであり、歯科修復ソリューションのデザイン入力に使用できます。さまざまなソースからのデジタル画像を表示して画質を高め、解析プロセスおよび治療計画をサポートします。これらの画像は、システム内でも、異なる場所にある複数台のコンピューターシステム間でも保存および提供することができます。

対象ユーザーおよび対象患者のターゲットグループ

DTX Studio™ Clinicは学際的治療チームによって使用され、歯科、頭蓋顎顔面または関連治療を受ける患者の治療をサポートします。

他のデバイスとの必要な互換性

DTX Studioエコシステムは、最も使用されているオペレーティングシステムであるWindowsおよびMac(最新リリースを含む)と互換性があります。

口腔内センサー

KaVo GXS-700™、KaVo IXS™、DEXIS™Titanium、Gendex™ GXS-700、DEXIS Platinum。

口腔内カメラ

KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD、KaVo DIAGNOcam、CariVu™、DEXIS DexCAM™ 4HD、KaVo ErgoCAM™ One、Gendex GXC-300™、DEXIS DexCAM 3、DEXIS DexCAM 4。

口腔内スキャン

MEDIT i500/KaVo X 500、MEDIT i700/KaVo X 700口腔内スキャナーまたは他の互換性のあるモデルをサポートする、Medit Linkソフトウェア*およびMEDIT Scan for DTX Studio*との互換性。

ソフトウェア

DTX Studio Core*、DTX Studio Implant、DTX Studio Go、DTX Studio Lab*、CyberMed OnDemand3D™*、Osteoid(以前のAnatomage) InVivo™。

* 製品はWindows版のみです。

測定機能を備えたデバイス

測定値の精度は、画像データ、使用されるスキャナー、キャリブレーションおよび取得設定によって異なります。測定値の精度は、画像の解像度より高くなることはありません。DTX Studio™ Clinicソフトウェアは、ユーザーが選択した小数点の一桁下で四捨五入した値を報告します。

禁忌

N/A

サイバーセキュリティ

DTX Studio™ Clinicを使用するコンピュータには、ファイアウォールを正しく構成したうえで、最新かつ有効なウイルス対策ソフトウェアやマルウェア対策ソフトウェアをインストールすることをお勧めします。

さらに、コンピュータから離れる場合は、必ずコンピュータをロックしてください。そうしないと、診断および計画、または治療の意図しない取り扱いにつながる可能性があります。

互換性

DTX Studio™ Clinicは、他の医療機器と接続されており、以前のバージョンのDTX Studio™ Clinicと互換性があります。

ソフトウェアバージョンを更新した後は、開いている患者の症例や治療計画の重要な設定を確認して、新しいソフトウェアバージョンでこれらの設定が正しいことを確認することをお勧めします。設定が正しくないと、診断および計画または実際の治療の遅延あるいは再スケジュールにつながる可能性があります。

相互運用性

DTX Studio™ Clinicは、以下の製品との相互運用が可能です。

- DTX Studio Core.
- DTX Studio Implant.
- DTX Studio Go.
- DTX Studio Lab.
- CyberMed OnDemand3D.

耐用年数

ソフトウェアの場合、耐用年数は3年です。サポートされているオペレーティングシステムで使用すると、ソフトウェアによって用途に応じてパフォーマンスが維持されます。

パフォーマンスの要件および制限

DTX Studio™ Clinicは、承認されているオペレーティングシステムでのみ使用してください。詳細については[システム要件](#)、IFUのを参照してください。

臨床的利点と望ましくない副作用

DTX Studio™ Clinicは、歯科または頭蓋顎顔面治療のコンポーネントです。歯科医は、このソフトウェアが診断および治療計画プロセスをサポートすることを期待できます。

DTX Studio™ Clinicでは、望ましくない副作用は確認されていません。

施設およびトレーニング

歯科医は、インプラント、補綴物、および関連するソフトウェアの経験の有無（経験値）にかかわらず、新しい治療法に着手する前には必ず、そのための研修を受けることを強く推奨します。

ソフトウェアの知識と理解が不足していると、診断および計画または実際の治療の遅延あるいは再スケジュールにつながる可能性があります。

ノーベルバイオケアは、歯科医師が知識や経験のレベルに合わせて選択できるように、さまざまなコースを提供しています。

詳細については、tw.dtxstudio.comのトレーニングサイトを参照してください。

重大な事故に関する通知

このデバイスの使用中、または使用の結果として、重大な事故が発生した場合は、製造元および各国当局に報告してください。重大な事故を報告するための、このデバイスのメーカーの連絡先は以下のとおりです。

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

医療従事者用

DTX Studio™ Clinicは医療従事者専用です。

システム要件

ソフトウェアのインストールを開始する前に、[システム要件](#)を確認してください。最小要件や推奨要件に関する情報を入手するには、テクニカルサポートまでお問い合わせください。ソフトウェアの新しいバージョンでは、ハードウェアまたはオペレーティングシステムによっては、より高い要件が必要になる場合があります。

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストール方法に関する情報を入手するには、認定された技術者またはテクニカルサポートまでお問い合わせください。

取り扱い手順

ソフトウェアの使用法の詳細については、この取扱説明書の詳細な手順を参照してください。

注記

ソフトウェアで提供される診断および計画ツールを使用するときは、特に以下の点に注意を払うことが重要です。

- 対象となる適応症が正確であること（可視化、測定、重要な構造、インポートデータ、インプラント計画）。
- 自動化された機能の結果が正確であること（デンタルスキャンのアライメント、穴の自動充填、および気道セグメンテーション）。
- 患者IDが正確であること（PMSシステムを介して患者記録を開いた後およびスキャンリクエストを作成するとき）。
- データが古いものでなく、最新であること。

これらを満たさないと、診断と計画または治療の見直しが必要になるリスクが高まり、その結果、診断および計画または実際の治療の遅延あるいは再スケジュールにつながる可能性があります。

警告および注意事項

警告

次の警告がソフトウェアに表示されます。



- **DICOMファイルで使用される名前は、患者の名前とは異なります。**
誤ったデータを使用して患者モデルを作成するリスクを軽減するには、患者名を確認し、患者名と使用されるDICOMセットの名前が一致するかどうかを確認してください。
- **現在の解析に3Dスキャンを追加できません。**
現在の診断には、手術計画にリンクされた3Dスキャンが含まれています。新しい解析を作成して3Dスキャンをインポートします。
- **現在の解析に手術計画を追加できません。**
現在の解析に含められた3Dスキャンに基づいて、手術計画を選択します。
- **8ビットで画像をエクスポートした場合は、忠実性に欠ける可能性があります。**
画質を維持するために、画像を別の形式でエクスポートすることをお勧めします。
- **患者を放射線にさらさないでください。**
機器を準備できませんでした。この状態では、機器はX線照射を受けられません。機器を再接続するか、再起動してもう一度試してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
- **次の照射用のセンサーを準備しています。お待ちください。**
機器は現在再準備中です。この状態では、機器はX線照射を受けられません。
- **機器のスキャンリクエストパラメータを確認してください。**
患者をスキャンする前に、機器のパラメータを確認してください。
- **実際のインプランの形状を使用せずに治療計画を変更することはお勧めできません。**
実際の形状は、DTX Studio Goからダウンロードできます。
- **画像が反転されています。**
この警告は、ユーザーが画像を手動で(水平または垂直に)反転した場合に表示されます。
- **口腔内画像の自動ソート(MagicSort™)は、癒合歯、叢生、巨大歯のない永久歯列にのみ使用することを目的としています。**
適切な条件から外れる患者の画像にMagicSortを使用するリスクを減らすため。

DTX Studio™ Clinicでは、技術的な警告(CTデータの矛盾など)が数多く表示されます。

より正確にスキャンするために、ソフトウェアの手順と技術的な通知に従うことを強くお勧めしています。

画像キャプチャ機器を使用する場合は、特に注意することをお勧めします。誤った使い方をすると、診断および計画または治療の遅延や再スケジュールに至ったり、患者に不必要な追加の放射線被ばくを与える恐れがあります。

特に、割り当てられた歯番号とビューアの方向のマーキングに注意を払うことをお勧めします。割り当てられた歯番号や患者の方向が誤っていると、患者に対する治療が正しく行われない可能性があります。

ソフトウェアからレポートまたは患者データを抽出する場合に、匿名化されていない患者データが、患者の同意なしに誤った目的に使用される可能性があることを理解しておくことが重要です。

注意事項



- 新しい治療法や機器を使用する際は、事前にトレーニングを受けておくことをお勧めします。
- 新しい機器や治療法を初めて使用する際は、その新しい機器の使用法や治療法に関して経験が豊富な歯科医とともに治療を行うことで、可能性のある合併症を防ぐことができます。
- より正確にスキャンするために、スキャンプロセス中は患者の動きが最少に抑えられていることを必ず確認します。

システム要件

オペレーティングシステム

- Windows®64ビット (ProおよびEnterpriseエディション) :
 - Windows 10
 - Windows 11
- IntelベースのMac (*) :
 - macOS Big Sur (11)
- Apple Silicon Mac (M1チップ以上) :
 - macOS Big Sur (11)

(*) 2012年以降のすべてのIntelベースモデルがサポートされています。

機器



- Windowsデスクトップ
- Windowsノートブック
- iMac®, Mac®Mini、Mac Pro®, MacBook Pro®, MacBook Air® (*)

*一部のMacBook Air®およびMac® Mini構成のグラフィックカードには、ボリュームレンダリングに関する制限があります。低解像度のボリュームレンダリングを選択することを検討してください。

	基本的なセットアップ (2D画像のみ)	推奨されるセットアップ (2Dおよび3D画像においてパフォーマンスが向上する)
CPU	デュアルコアまたはクアッドコア	2.8 GHzクアッドコア (インテルCore i5またはi7)
RAM	4 GB	8 GB以上
グラフィックカード	エントリーレベルの専用アドインカードまたはインテルの統合型グラフィックカード。インテル*の統合型グラフィックカードの場合、Gen9以降。OpenGL® 3.3のサポートが必要です**。	最適な3Dサポート (OpenGL 3.3)と2 GB以上のメモリ (AMDやNVIDIAなど)を備えた専用のアドイングラフィックカード。4Kディスプレイの場合:4 GB以上のメモリ。インテル*の統合型グラフィックカードもサポートされています (Gen9以降)。
	* 最高のパフォーマンスを得るには、それぞれのモデルにインテルから入手可能な最新の統合型グラフィックカードのドライバを常に使用してください。 ** グラフィックカードのOpenGL®バージョンを確認するには、 http://realtech-vr.com/admin/glview をご覧ください。	
ディスク容量	インストール用の10 GBの空きディスク容量と、ユーザー作成データ用の追加のディスク容量。DTX Studio™ Clinicの一般的な2D患者データセットは約10 MBです。	インストール用の10 GBの空きディスク容量と、ユーザー作成データ用の追加のディスク容量。DTX Studio™ Clinicの一般的な3D患者データセットは約250 MBです。
ネットワーク	アップロード速度が3 Mbps、ダウンロード速度が30 Mbpsのブロードバンドインターネット接続。 常時インターネットに接続しておくことをお勧めします。それができない場合、DTX Studio™ Clinicへのアクセスが一時的に中断される可能性があるため、少なくとも14日に1回接続する必要があります。	
ハードディスク	Macデバイスの場合は、HFS+またはHFSJの大文字と小文字を区別しないドライブにのみDTX Studio™ Clinicをインストールしてください。	
モニター	フルHD (1,920×1,080) 以上。	
LAN	DTX Studio™ ClinicをDTX Studio Coreと一緒にインストールする場合は、ローカルのギガビットネットワークをお勧めします。	

開始

DTX Studio™ Clinicの起動


1. DTX Studio™ Clinicを開きます。
 - Windowsでは、デスクトップのショートカットアイコン  をダブルクリックします。
 - macOSでは、FinderアプリケーションフォルダまたはDock内のショートカットアイコン  をクリックします。
2. ユーザーを選択します。
3. パスワードを入力します。
4. [ログイン]をクリックします。

備考

DTX Studio Goに2要素認証を設定すると、30日ごとに6桁の確認コードを入力してログインする必要があります。

DTX Studio™ Clinicは、常時インターネットに接続しておく必要があります。それができない場合、DTX Studio™ Clinicへのアクセスが一時的に中断される可能性があるため、少なくとも14日に1回接続する必要があります。

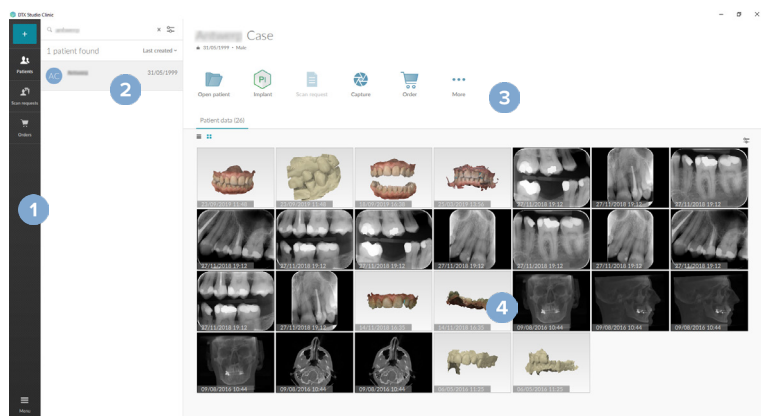





作業領域の解説



- 1 サイダー
- 2 患者リスト
- 3 アクションウィンドウ
- 4 詳細ウィンドウ

通知領域の解説

通知領域のDTX Studio™ Clinicアイコン  から、DTX Studio™ Clinicの設定  と以下の機能にアクセスできます。

- **通知**:アップロードしている患者記録またはDTX Studio Coreと同期されている患者記録が表示されます。
- **DTX**:DTX Studio Core , DTX Studio Go , 照射線量レポート*, QuickPrescribe*, スキャンセンター*, またはリンクされている他社製アプリケーションにすばやくアクセスできます。
- **機器**:画像取得装置とそのステータス (USBまたはTWAIN経由で接続 , オンライン , ビジー , またはオフライン ) が表示されます。機器の設定にアクセスしたり、不要な機器を無効にしたりするには、... をクリックします。

* DTX Studio Coreが必須です。

設定の調整

DTX Studio™ Clinicのデフォルト設定の調整

1. [メニュー] ≡ をクリックします。
2. [設定] ⚙ をクリックします。

設定のインポートまたはエクスポート

DTX Studio™ Clinicまたは患者モジュールで設定されたプリファレンスを含む設定ファイルを作成またはインポートします。これは、設定を新しいインストールにエクスポートしたり、DTX Studio™ Clinicの他のユーザーと設定を共有したり、バックアップを作成したりする場合に便利です。

注記

詳細については、ヘルプファイルの「設定の共有」トピックを参照してください。≡ をクリックし、[ヘルプ] を選択してください。

設定サイドバーで、[設定の共有] をクリックします。

- 設定ファイルをインポートするには、[インポート] セクションの [参照] をクリックします。設定ファイルを選択して、[保存] をクリックします。[インポート] をクリックして確定します。
- 設定ファイルをエクスポートするには、[エクスポート] セクションの [参照] をクリックします。必要に応じてファイル名を変更し、[保存] をクリックします。[エクスポート] をクリックして確定します。

言語と日付/時刻形式の変更

使用言語と日付および時間の形式を調整するには、次の手順に従います。

1. 設定サイドバーの [地域] をクリックします。
2. [短い日付形式]、[長い日付形式]、および [時刻形式] リストで、日付と時刻の形式を選択します。
3. [アプリケーションの言語] リストから使用する言語を選択します。
4. [OK] をクリックします。
5. 変更を有効にするには、DTX Studio™ Clinicを再起動してください。

DICOM準拠の設定の調整

DIN 6862-2規格への準拠を確認するには、施設情報を入力します。DICOMファイルをエクスポートすると、提供された機関情報で空のタグが置き換えられます。

1. 設定サイドバーの [プラクティス] をクリックします。
2. [DIN 6862-2規格を使用] を選択します。
3. 要求された機関情報を入力します。
4. [OK] をクリックします。

注記

準拠するDICOMファイルをインポートおよびエクスポートすると、DIN 2020タグが常に保持されます。

デフォルトのイメージフィルタの設定

クリニックビューアと患者モジュールについて、DTX Studio™ Clinicでデフォルトのイメージフィルタを設定するには、次の手順に従います。

1. **設定**または患者モジュールのプリファレンスのサイドバーで、**[画像設定]**をクリックします。
2. **[デフォルト画像設定]**リストから、デフォルトのフィルタ設定を設定する画像タイプを選択します。

注記

ガンマフィルタのカスタム値を設定するには、**[デフォルト画像設定]**リストから**[OPG]**、**[口腔内]**、または**[セファログラム]**を選択します。**[ガンマ]**オプションを**[手動]**に設定します。

3. 選択した画像タイプのデフォルトとして使用するフィルタを選択し、表示されたスライダーを使用してフィルタのパーセンテージを設定します。
4. **[OK]**をクリックします。

初期設定のデフォルト値に戻す場合は、**[リセット]**をクリックします。

口腔内画像の自動回転の無効化

即時スキャンを実行すると、口腔内画像は自動的に正しい位置に回転します。この機能を無効にするには、次の手順に従います。

1. **設定**または患者モジュールのプリファレンスのサイドバーで、**[画像設定]**をクリックします。
2. **[DTX Studioのキャプチャで自動回転を適用する]**の選択を解除します。

レベルとウィンドウの値の自動設定の無効化

2D画像をインポートまたは取得すると、レベルとウィンドウの値が自動的に設定されます。この機能を無効にするには、次の手順に従います。

1. **設定**または患者モジュールのプリファレンスのサイドバーで、**[画像設定]**をクリックします。
2. 右上のドロップダウンメニューで、**[OPG]**、**[口腔内]**、または**[セファログラム]**を選択します。
3. **[自動レベルウィンドウ]**の選択を解除します。
4. カスタムレベルとウィンドウの値を入力します。
5. **[OK]**をクリックします。

DTX Studio Coreへの接続

DTX Studio Coreは、患者のさまざまな種類のメディアや画像データ (2D X線、3D (CB) CT X線、歯科光学スキャン、写真) を一元化した方法で保存して取り出すためのソフトウェアソリューションです。これにより、歯科院内のどこからでもすぐにデータにアクセスできるようになります。

- DTX Studio™ ClinicとDTX Studio Coreを接続している場合は、DTX Studio™ Clinicをネットワーク環境で使用できるため、他の対応機器 (イーサネット接続された対応する3Shape TRIOS®) から画像を取得することができます。
- ネットワーク機器のスキャンリクエストを処理し、X線レポートにアクセスするには、DTX Studio Coreと接続する必要があります。

DTX Studio Coreとの接続を確立するには、次の手順に従います。

1. [設定](#)サイドバーの[Core]をクリックします。
2. [URL] (Webアドレス)を入力し、DTX Studio Coreの[ログイン]と[パスワード]を入力します。
3. [接続]をクリックします。

アクションウィンドウへのアプリケーションの追加

アクションウィンドウにアプリケーションのショートカットを追加するには、次の手順に従います。

1. [設定](#)サイドバーの[クイック起動]をクリックします。
 2. [追加]をクリックします。
 3. 実行可能ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
 4. 必要に応じて、[アプリケーション名]を変更します。
 5. 必要に応じて、[患者データを読み込んで起動]を選択し、患者データを読み込んで他社製アプリケーションを起動します。
- エクスポートパラメータを[エクスポートパラメータ]フィールドに追加して、エクスポートするデータを指定します。

注記

すべての患者データのパラメータ詳細については、ヘルプファイルのクイック起動のトピックを参照してください。

- [参照]をクリックして、エクスポートしたデータの保存場所を選択します。
6. [OK]をクリックします。

プラクティスマネージメントシステム(PMS)統合の有効化

DTX Studio™ ClinicをPMS (VDDSまたはOPPを介して)/OPPウェブと統合すると、PMS内に患者記録を作成したり、PMSから画像を取得したりできます。

PMS画像をDTX Studio™ Clinicでプレビューしたり、DTX Studio™ Clinic患者モジュールに直接表示したりできます。

1. [設定](#)サイドバーの[PMS統合]をクリックします。
2. [PMS統合の有効化]を選択します。

DTX Studio™ ClinicへのTWAIN機器の追加

DTX Studio™ ClinicにTWAIN対応機器を追加するには、次の手順に従います。

1. [設定](#)サイドバーの[機器]をクリックします。
2. [追加]をクリックします。
3. TWAIN機器を選択します。
4. 機器の設定を構成します。
5. [追加]をクリックします。

使用可能なすべてのショートカットの表示

使用可能なすべてのショートカットを表示するには、[メニュー] ≡ をクリックし、[キーボードショートカット] を選択します。


DTX Studio™ Clinicの終了

開いている患者およびスキャンモジュール*のすべてのインスタンスを終了してください。

ソフトウェアを終了する

1. [メニュー] をクリックします。
2. [アプリケーションを閉じる] をクリックします。

注記

終了ボタン  を使用すると、ソフトウェアはバックグラウンドで実行されるため、データの同期が可能になり、DTX Studio™ Clinicを再度開くときの反応が早くなります。

* モジュールはライセンス契約されている可能性があります。

主な機能の概要

主な機能を使用するには、次の手順に従います。



-
- | | | | |
|---|------------------|---|---|
| 1 | 患者記録を作成またはリンクする |  | DTX Studio™ Clinicで患者記録を作成します (17ページを参照)。 |
| | |  | プラクティスマネジメントシステムを統合し (14ページを参照)、既存のPMS患者記録をリンクします。 |
| 2 | データを取得またはインポートする |  | スキャンまたは複数のスキャンデジタルワークフローを取得します (23ページを参照)。 |
| | |  | スキャンまたはスキャンデジタルワークフローをリクエストします (21ページを参照)。 |
| | |  | 患者レコードに画像をドラッグアンドドロップします (17ページを参照)。 |
| | |  | オンデマンドでデータを移行します (データベース移行を伴うセットアップの場合) (30ページを参照)。 |
| | |  | 3Shape Dental Desktopソフトウェアからインポートします (20ページを参照)。 |
-

患者記録が作成されたら、次の手順に進みます。


-
- | | | |
|---------------|---|---|
| 解析し、治療の計画を立てる |  | 患者モジュールを開きます (27ページを参照)。 |
| |  | 必要に応じて、DTX Studio Implantを開きます (44ページを参照)。 |
| 共有してやり取りする |  | DTX Studio Goを使用してデータを共有します (19ページを参照)。 |
| |  | 患者記録をエクスポートします (18ページを参照)。 |
| |  | レポートまたは患者への連絡レターを作成します (43ページを参照)。 |
| オーダーする |  | 必要に応じて、補綴修復、サージカルテンプレート、または手術計画をオーダーします (44ページを参照)。 |
-

患者記録

新しい患者記録の作成




1. [患者を追加]  をクリックします。
2. [患者を作成] を選択します。
3. 患者名、生年月日、性別など、基本的な患者情報を入力します。
4. [作成] をクリックします。
5. 患者記録が[患者]  リストに追加されます。DTX Studio™ ClinicがDTX Studio Coreに接続されている場合は、DTX Studio Coreにも患者記録が追加されます。

患者記録の管理

患者リストをまだ開いていない場合は、サイドバーの[患者]  をクリックして患者リストを開きます。

注記


ワークステーションがDTX Studio Coreに接続されていない場合は、ローカルに保存されている患者記録だけが表示されます。

- ローカルのワークステーションまたはネットワークに接続されたワークステーションの患者モジュールで開かれた患者記録には、 マークが付いています。
- 患者の基本情報を編集するには、患者リストで患者記録を選択し、[その他] ... をクリックして[編集]  を選択します。
- 患者を削除するには、患者リストで患者記録を選択し、[その他] ... をクリックして[削除]  を選択します。
- DTX Studio Coreに保存されている患者記録をオフラインでも利用できるようにするには、[その他] ... をクリックし、[オフライン利用可能] を有効にします。
- 互換性のある画像タイプを患者記録にドラッグアンドドロップします。画像がインポートされます。


通知領域 ([11ページを参照](#)) には、アップロードされている患者記録または同期されている患者記録が表示されます。


プライバシーオプションの管理

患者のプライバシーを確保するには、次の手順に従って、患者リストに患者のイニシャルのみを表示するか、患者リストを完全に非表示にします。

1. 患者リストで、 をクリックします。
2. イニシャルのみを表示するには、[患者モード] を選択し、患者リストを完全に非表示にするには、[患者リストを非表示] を選択します。

備考

患者リストを再度表示するには、サイドバーの  をクリックします。

患者モードは、DTX Studio™ Clinicを再起動した場合でも有効のままです。患者モードをオフにするには、もう一度  をクリックし、[患者モード] をオフにします。



患者記録の検索とソート

患者記録を検索するには、患者リストをソートするか、検索機能を使用します。

患者リストのソート

1. 患者リストの見出しの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
2. [最終作成日]、[最終変更日]または[最終キャプチャ]を選択します。
3. もう一度ドロップダウンリストをクリックして閉じます。

患者の検索

1. 患者リストで、 をクリックします。
2. 検索する患者の[患者名]、[生年月日]または[患者ID]を選択します。
3. 選択した検索オプション(の一部)を[患者検索]  フィールドに入力します。
4. 検索ボックスにテキストを入力すると、患者リストが自動的にフィルタリングされます。

検索条件を削除するには、検索フィールドで  をクリックします。



患者記録のエクスポート

患者記録をエクスポートして、解析および画像データを別のDTX Studio™ Clinicユーザーと共有することができます。また、エクスポートされた患者記録は、無料版のDTX Studio™ Clinicで表示でき、DTX Studio Go経由で利用できます。

注記





ソフトウェアからレポートまたは患者データを抽出する場合に、匿名化されていない患者データが、患者の同意なしに誤った目的で使用される可能性があることを理解しておくことが重要です。

患者記録のエクスポート

1. 患者リストで患者記録を選択します。
2. [詳細]  をクリックします。
3. [患者データのエクスポート]  をクリックします。
4. エクスポートする解析を選択します。患者記録全体をエクスポートするには、[患者全体のエクスポート]を選択します。
5. 患者記録を保存する場所に移動して、[エクスポート]をクリックします。

DTX Studio Goを介した患者データの共有

DTX Studio Goを介して歯科医院と患者データを共有します。患者データを共有すると、追加の[GoShare]タブに概要が表示されます。

1. 患者記録のアクションウィンドウで、[共有]  をクリックします。
2. 共有する対象を選択します。
 - [患者様全体]  :患者記録全体 (DTX Studio™ Clinic独自の暗号化形式) を共有する場合。
 - [患者データ]  :特定のデータを共有する場合。
3. 目的のオプションを選択します。
4. [続ける] をクリックします。
5. WebブラウザでDTX Studio Goを開くと、作成したGoShare症例が表示されます。一方、データはバックグラウンドでアップロードされます。
 - [プレスクリプション]カードのテキストフィールドに備考を追加します。
 - 治療内容のテンプレートを作成するには、[簡単な備考を挿入] をクリックして[構成] を選択します。[簡単な備考の追加] をクリックします。タイトルを追加し、テキストを入力して、[保存] をクリックします。[閉じる] をクリックします。
 - デフォルトのプレスクリプション画像を変更するか、または注釈を追加するには、プレスクリプション画像にポインタを合わせて[プレスクリプションの編集] を選択します。別の画像を選択するには、[画像の変更] をクリックします。
 - 患者情報を編集するには、右上隅にある  をクリックします。
 - 必要に応じて、CB (CT) 画像、臨床写真、口腔内画像、OPG、レポートなどの詳細情報または追加ファイルを提供します。
6. [共有の開始] をクリックします。
7. 患者データを共有するための接続を選択します。[コネクションと共有] フィールドで既存の接続を検索または選択するか、あるいは電子メールアドレスを入力します。
8. [送信] をクリックします。受信アカウントは電子メールで通知されます。
9. 患者記録のGoShareの概要に共有された症例が追加されます。共有された症例をDTX Studio Goで開くには、[症例の表示] をクリックします。

3Shape Dental Desktopソフトウェアからのインポート

3Shape TRIOS口腔内スキャナーで取得したスキャンをインポートするには、最初にDTX Studio™ Clinicで患者記録を作成する必要があります。

注記




3Shape TRIOS口腔内スキャナーの統合方法については、『DTX Studio Coreクイックガイド』を参照してください。

1. DTX Studio™ Clinicで新規患者記録を作成します。3Shapeデータが確実にマージされるようにするには、次の手順に従います。
 - 3Shape Dental Desktopの既存の患者とまったく同じ名、姓、生年月日を使用します。
 - 患者名に正しい大文字が使われていることを確認してください。名前の大文字と小文字は区別されます。

備考

以前にインポートされた患者記録は再インポートできません。3Shape Dental Desktopで患者記録を複製し、代わりに複製された患者レコードをインポートします。

DTX Studio™ Clinicの患者記録IDは3Shapeと交換されません。リンクは、名、姓、生年月日が一致することをユーザーが確認したうえで作成されます。


2. **患者**  リストで患者記録を選択します。
3. [詳細]  をクリックします。
4. [3Shapeからインポート]  を選択します。
5. 必要に応じて、患者記録が3Shape Dental Desktopの症例と一致していることを確認してください。
6. データが取得され、[患者の詳細] パネルの[患者データ] タブに追加されます。

スキャンのリクエスト

スキャンリクエストを処理したり、複数のスキャンプロトコル(22ページを参照)を使用してスキャンデジタルワークフローを開始したりするには、DTX Studio Coreとの接続を確立する必要があります(13ページを参照)。

スキャンのスケジュール

患者のスキャンを依頼するには、次の手順に従います。

1. 患者リストで患者記録を選択します。
2. [スキャンリクエスト]  をクリックします。
3. 必要に応じて、複数のスキャンプロトコルを使用してスキャンデジタルワークフローを開始します(22ページを参照)。
4. 画像取得装置の画像タイルの上にカーソルを合わせ、[選択] をクリックします。
5. スキャンリクエストフォームに適切な情報を入力します。


注記

選択した様式に応じて、フォームは異なります。


- 画像取得機器で複数の様式を利用できる場合は、必要な様式を3D、CEPH(セファログラム)、OPG(PAN)、IOXRAY(2D口腔内スキャン)、IOS(3D口腔内スキャン)、IOCAM(口腔内写真)から選択します。該当する場合は、画像取得プログラムを選択します。
 - 歯式チャートで、スキャンする領域を選択します。
 - 必要に応じて、[スキャン日]と[依頼元の歯科医師]を変更します。
 - 上顎洞をスキャンする必要がある場合は、[上顎洞]を選択します。
 - 必要に応じて、画像取得の解像度を選択します。
 - 選択した機器が口腔内機器である場合は、[テンプレート]を選択し、[画像取得プログラム]を指定します。
 - 必要に応じて、オペレーターのために[依頼の備考]を追加します。
6. [スキャンリクエストを作成] をクリックします。スキャンリクエストが追加されます。


スキャンリクエストの検索とソート

スキャンリクエストリストのソート

1. サイドバーの[スキャンリクエスト]  をクリックします。
2. [スキャンリクエスト]リストの見出しの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
3. ソート項目として[予定日]または[作成日]を選択します。

スキャンリクエストの検索

1. [スキャンデータの検索]フィールド  に予定日または患者名(一部でも可)を入力します。
2. 検索ボックスにテキストを入力すると、スキャンリクエストリストが自動的にフィルタリングされます。検索結果が、予定日に基づいてソートされます。


検索条件を削除するには、検索フィールドで  をクリックします。

スキャンデジタルワークフロー

QuickPrescribe機能を使用して、定義済みのスキャンリクエストの特定のセットを使用して、別のスキャンタイプからの複数のスキャンで構成されるスキャンデジタルワークフローを作成します。これらのスキャンデジタルワークフローは、すべてのワークステーションで使用できます。

まず、DTX Studio Coreでスキャンデジタルワークフローを定義してから、スキャンのスケジュール中に、またはキャプチャウィザードで適用します。

スキャンデジタルワークフローの定義

1. 画面の下部 (Macを使用している場合は画面上部) にある通知領域のDTX Studio™ Clinic  アイコンをクリックします。
2. [QuickPrescribe] をクリックします。スキャンデジタルワークフローをまだ設定していない場合は、[今すぐ始めましょう] をクリックします。
3. DTX Studio Coreでスキャンデジタルワークフローの設定を完了します。



注記

詳細については、DTX Studio Coreで、左下にある[ヘルプ] をクリックしてください。

4. スキャンリクエストまたはキャプチャウィザードでスキャンデジタルワークフローを選択します。

スキャンデジタルワークフローの適用

DTX Studio Coreでスキャンデジタルワークフローを定義した後、スキャンリクエストウィザードまたはキャプチャウィザードでそれを選択します。

1. 患者リストで患者記録を選択します。
2. [スキャンリクエスト]  または [キャプチャ]  をクリックします。
3. [QuickPrescribe] をクリックします。

備考

検索フィールドにスキャンデジタルワークフロー (の一部) を入力して、結果を絞り込みます。

設定されているすべての様式とパラメータを表示するには、リスト内のスキャンデジタルワークフロー名にカーソルを合わせます。[詳細情報] をクリックします。

4. リスト内のスキャンデジタルワークフロー名にカーソルを合わせ、[スキャンリクエストを作成] をクリックします。数字は、選択したスキャンデジタルワークフローで作成されたスキャンリクエストの数を示します。
5. 歯式チャートで、スキャンする解析領域を選択します。
6. [スキャンリクエストを作成] をクリックします。

スキャンの実行

スキャンリクエストを作成するかどうかにかかわらず、患者の解析前、解析中、または解析後にスキャンを取得します。


より正確にスキャンするために、ソフトウェアの手順と技術的な通知に従うことを強くお勧めしています。

予定されているスキャンの実行

スキャンリクエストでスキャンを実行するには、次の手順に従います。

1. スキャンリクエストカードで、**[開始]**をクリックします。
2. 装置のタイル表示にカーソルを合わせて、**[選択]**をクリックします。
3. スキャンを実行する機器に移動します。
4. アクションを終了するには、**[終了]**をクリックします。患者モジュールを開くには、**[診断を開く]**をクリックします。

即時スキャンの実行

1. 患者リストで患者記録を選択します。
2. **[キャプチャ]**  をクリックします。
3. 装置のタイル表示にカーソルを合わせて、**[選択]**をクリックします。

備考

口腔内画像は自動的に正しい位置に回転します。この機能を無効にするには、[13ページを参照](#)してください。

2D画像をインポートまたは取得すると、レベルとウィンドウの値が自動的に設定されます。この機能を無効にするには、[13ページを参照](#)してください。

センサーサイズの異なる複数のセンサーを使用するには、キャプチャウィザードでそれらをプラグインまたはプラグアウトします。使用されているセンサーは右上隅に表示されます*。

複数のセンサーが接続されている場合は、+記号が表示されます*。接続されアクティブになっているすべてのセンサーは、スキャンを取得する準備ができています。X線が画像取得のトリガとなります。

* DTX Studio™ Clinicで直接サポートされているセンサーとPSPの場合、TWAINを介して接続する機器の場合、この機能は制限されます。

口腔内センサーまたはPSP機器によるガイドあり取得

テンプレートを使用して口腔内画像を取得するには、次の手順に従います。

1. 即時スキャンを開始します。
2. **[テンプレート]** タブをクリックし、目的のテンプレートを選択します。
3. 取得するレイアウトと画像を選択します。
4. **[開始]** をクリックします。
5. スキャンを実行する機器に移動します。
6. プレビューページで、取得した画像を確認します。プレビュー画像にカーソルを合わせると、**[回転]**、**[反転]**、**[イメージフィルタ]** の表示/非表示、および **[再度キャプチャ]** オプションが表示されます。必要に応じて変更します。
7. **[終了]** をクリックします。

口腔内センサーまたはPSP機器によるガイドなし取得

テンプレートを使用せずに口腔内画像を取得するには、次の手順に従います。

1. 即時スキャンを開始します。
2. [フリー]タブを選択します。
3. スキャンを実行する機器に移動します。



MagicSort自動検出をアクティブにしている場合は、以下の手順を参照してください。

- 右下隅に、MagicSort自動検出アイコンが表示されます。
- キャプチャウィザードで、歯が自動的に検出されます。それらには青色のマークが付いています。MagicSortラベルを削除するには、歯をクリックします。
- 口腔内画像は、FMXチャートに自動的にマッピングされます。
- 必要に応じて、歯式チャートに未確認の画像を手動で示します。

注記

デフォルトでは、MagicSort自動検出がアクティブになっています。これは、設定で無効にすることができます。

4. 必要に応じて、プレビューページで、取得した画像を調べ、歯の範囲を割り当てます。
 - 歯の範囲で指定した歯を削除する場合は、[選択の消去]をクリックします。
 - 必要に応じて変更を加えます。プレビュー画像にカーソルを合わせると、[回転]、[反転]、[イメージフィルタ]の表示/非表示、および[再度キャプチャ]オプションが表示されます。
 - 必要に応じて、取得した画像を回転または反転します。

アクション

アイコン ショートカット

画像を反時計回りに回転



[Alt+←]または[R]

画像を時計回りに回転



[Alt+→]または[Shift+R]

口腔内画像または臨床写真を水平方向に反転します。



[U]

口腔内画像または臨床写真を垂直方向に反転します。



[Shift+U]

口腔内カメラによるガイドあり画像取得

テンプレートを使用して口腔内カメラ画像を取得するには、次の手順に従います。

1. 即時スキャンを開始します。
2. [ガイドド] タブを表示したままにします。
3. 口腔内カメラの場合は、取得対象の歯を選択します。
4. 機器のボタンを押すか(利用できる場合)、[画像キャプチャ] をクリックします。
5. 別の歯を選択して口腔内画像を撮影するには、← または → キーボードボタンを使用します。または、歯の範囲から歯をクリックするか、[前へ] または [次へ] をクリックします。

注記

1本の歯につき1枚の画像のみが必要な場合は、[キャプチャ後、次の歯に進みます] を有効にすると、自動的に次の歯に進みます。

6. [終了] をクリックします。

口腔内カメラによるガイドなし画像取得

テンプレートを使用せずに口腔内カメラ画像を取得するには、次の手順に従います。

1. 即時スキャンを開始します。
2. [フリー] タブをクリックします。
3. 機器のボタンを押すか(利用できる場合)、[画像キャプチャ] をクリックします。
4. 取得した画像を歯に割り当てるには、下部にある画像のサムネイルをクリックして、歯の範囲で対応する歯を選択します。


注記

画像を選択し、歯をクリックして他の歯にドラッグすることにより、複数の歯に画像を割り当てることができます。

5. [終了] をクリックします。

口腔内スキャン

3Shape TRIOS® スキャナー

1. [キャプチャ]  をクリックします。
2. 3Shape口腔内スキャナーを選択し、[選択] をクリックします。
3. 3Shape Dental Desktopアプリケーションでスキャンを開始します。

注記


3Shape TRIOS口腔内スキャナーの統合方法については、『DTX Studio Coreクイックガイド』を参照してください。

4. スキャンプロセスを完了します。
5. 画像は、[患者詳細] パネルの [患者データ] タブに追加されます。
 - 完了したスキャンリクエストには、チェックマークが付きます。
 - 患者モジュールで新しい診断を開始するには、[診断を開く] をクリックします。

KaVoスキャナーとMeditスキャナー

スキャンモジュール*を使用すると、サポートされているMedit/KaVo口腔内スキャナーをDTX Studio™ Clinicで使用して、既存のスキャン症例を再度開くことができます。

口腔内のスキャンデータを取得する

1. 患者リストで患者記録を選択します。
2. [キャプチャ]  をクリックします。
3. 口腔内スキャナーを選択し、[選択] をクリックします。
4. スキャンモジュールが開きます。
5. 指示に従います。
6. 処理済みデータが患者記録に追加されます。

スキャン症例を再度開く

ローカルでキャプチャされた口腔内スキャンデータは、スキャンモジュールで再度開くことができます*。

注記

これは、スキャンデータの取得に使用したコンピュータでのみ可能です。


スキャンモジュール*を再度開いてスキャンを編集するには、追加のスキャン、トリミング、測定を行います。

1. 患者記録で、デンタルスキャンタイルをクリックします。
2. [Medit Scanで開く] をクリックします。

* Windowsコンピュータのみ、さらに口腔内スキャンデータの取得に使用したコンピュータで、スキャンのRAWデータが含まれるフォルダが利用可能な場合。適切なライセンスの種類またはMedit Scanの統合サブスクリプションのPlus+機能が必要です。追加のMedit Scanソフトウェアモジュールをインストールする必要があります。

解析または治療計画


患者モジュール(以前の解析モジュール)を使用すると、患者データを表示して検査したり、患者記録に所見や測定値を追加したりできます。

患者モジュールを開くには、[患者]リストで患者を選択し、[患者を開く]  をクリックします。または、患者リストで患者をダブルクリックするか、[O]を押します。

この機能はDTX Studio™ Clinicのライセンスの種類によって異なります。

ライセンスの種類	機能	画像取得
DTX Studio™ Clinic ProまたはPro IOS	2Dおよび3D	2Dおよび3D
DTX Studio™ Clinic Select	2Dおよび選択された3D表示機能	2Dのみ

患者モジュールの解説(以前の診断モジュール)

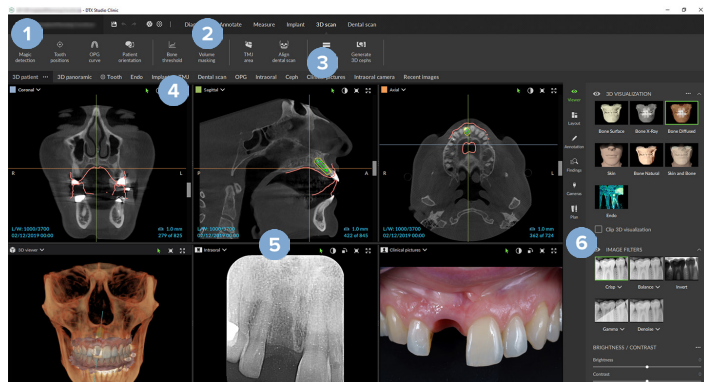

- 1 患者メニュー
- 2 メニューバー
- 3 ツールバー
- 4 ワークスペースバー
- 5 ワークスペース-スマートレイアウト
- 6 スマートパネル

患者メニューの使用


患者モジュールで、左上隅の☰をクリックして患者メニューを開きます。

メニューオプション

- [キャプチャ]: 患者モジュールから直接データを取得します。
- [インポート]: 開いている診断にデータをインポートします。
- [新規]: 新しい診断を作成します。
- [開く]: 別の既存の診断を開きます。
- [保存]: 開いている診断を保存します。
- [レポートのエクスポート]: 患者の診断レポートをエクスポートします。
- [キーボードのショートカット]: キーボードのショートカットの概要を表示します。
- [プリファレンス]: [デフォルトワークスペース]、[パフォーマンス]、[画像設定]、[3Dビューア]、[ツール]などの設定を変更します。
- [患者を閉じる]: 患者モジュールを閉じます。

診断用歯式チャート

[メニュー]をクリックします。患者メニューの歯式チャートには、開いている解析の概要が表示されます。







注記

患者が8歳未満の場合、乳歯の歯式チャートが表示されます。患者が成長したときに大人の歯式チャートに移動するには、歯を手動で変更する必要があることに留意してください。

歯式チャートの編集



歯式チャートを編集するには、歯式チャートで歯をクリックし、次のいずれかを選択します。

アイコン	アクション	説明
	交換	乳歯と永久歯を交換します。このオプションは、子どもの歯に対応する永久歯がある場合に使用できます。歯が生え変わった場合、乳歯のすべての所見が削除され、永久歯が健康な歯に設定されます。 注記 患者が8歳未満の場合、乳歯列が表示されます。
x	欠損(空隙あり)	この歯は欠損しており、この場所に空隙があります。
	埋伏	この歯は埋伏歯になります(親不知歯でよく使用されます)。
	挿入	歯を挿入します(子どもの歯列における大人の大白歯など)。
	欠損(空隙なし)	歯数不足を示します。

解析データ

歯式チャートの下に、開いている解析のスキャンおよび画像がデータのタイプごとに表示され、取得日に基づいてソートされます。

-  3Dスキャン
-  OPG(パノラマ画像)
-  口腔内画像
-  セファログラム
-  臨床写真
-  スクリーンショット
-  フェイススキャン
-  デンタルスキャン

- 3Dスキャンを切り替えるには、別の3Dスキャンをクリックします。
- 患者モジュールから直接データの取得を開始し、開いている診断にデータを追加するには、[キャプチャ]  を選択します。あるいは、メニューバーの  をクリックします。

データのインポート

データをインポートするには、患者メニューの[インポート] ↓ をクリックします

3Dスキャンのインポート

1. [インポート] ↓ をクリックし、[3Dスキャン]を選択します。
2. DICOMデータを選択します。
3. [次へ]をクリックします。
4. ISO値を設定します。
5. [終了]をクリックします。
6. MagicDetectが有効になっている場合(デフォルトでオン)、AI検出プロセスが開始され、CB(CT)データが自動的に設定されます。

後でランドマークとOPG曲線を手動で指定するには、[自動検出をスキップ]をクリックします。3D画像の向きは、患者の方向ウィザードによって最適化できます。OPG曲線アクション([41ページを参照](#))を実行すると、3D OPGを調整できます。

デンタルスキャンのインポート

1. [インポート] ↓ をクリックし、[デンタルスキャン]を選択します。
2. デンタルスキャンモデルを選択し、必要に応じて取得の詳細を追加します。
3. [次へ]をクリックします。
4. [終了]をクリックします。

フェイススキャンのインポート

1. [インポート] ↓ をクリックし、[フェイススキャン]を選択します。
2. インポートするフェイススキャンを選択します。
3. [開く]をクリックします。
4. 必要に応じて、[明るさ]と[コントラスト]を調整します。
5. [終了]をクリックします。

2D画像のインポート

1. [インポート] ↓ をクリックし、[2D画像] を選択します。
2. 画像を選択し、[開く] をクリックします。
3. [OK] をクリックします。
4. 追加する画像を選択します。
5. [インポート] をクリックします。
 - 2D画像をインポートまたは取得すると、レベルとウィンドウの値が自動的に設定されます。この機能を無効にするには、[13ページを参照](#)してください。
 - デフォルトでは、MagicSort自動検出がアクティブになっています。これは、設定で無効にすることができます。

3Dおよびデンタルスキャンビューアの背景の設定

患者モジュールで3Dまたはデンタルスキャンビューアのデフォルトの背景色を変更するには、次の手順に従います。

1. [プリファレンス] ウィンドウで、[3Dビューア] をクリックします。
2. [無地] を選択します。
3. ドロップダウンメニューで色を選択するか、[カスタム] を選択して他の色を選択します。
4. [OK] をクリックします。





デフォルトの画像ズームレベルの設定

患者モジュールに表示する画像のデフォルトのズームレベルを設定するには、次の手順に従います。

1. [プリファレンス] ウィンドウで、[ワークスペース] をクリックします。
2. [デフォルト画像サイズ] リストで、デフォルトの倍率を選択します。
3. [OK] をクリックします。

マウスの操作

ビューアを操作するにはマウスを使用します。







	アクション	3Dビューア	その他のビューアタイプ
	右クリックしながらドラッグ	3Dモデルを回転させる	明るさ/コントラスト(デフォルト)または拡大と縮小
	[Ctrl]+クリックしながらドラッグ、または[Cmd]+クリックしながらドラッグ	移動	移動
	[Shift]+クリックしながらドラッグ	拡大と縮小	拡大と縮小
	ホイールボタンをスクロール	拡大と縮小	リスライスビューアのみ:スライス全体をスクロール

ワークスペース

ワークスペースバーからワークスペースを選択するか、対応するショートカットキーを使用します (利用可能な場合)。

注記

画像またはデータが解析に追加されているワークスペースのみが表示されます。

ワークスペース	説明	ショートカットキー
3D患者	<p>読み込まれたされたモデルをすべての面から検査するには、マウス操作 (32ページを参照) とキーボードショートカットを使用します。または、以下の標準のクリニカルビューのアイコンを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none">  正面  背面  左側面  右側面  頭蓋方向  顎方向 <p>デンタルスキャンのワークスペースに移動するには、もう一度 [F2] キーを押します (利用可能な場合)。</p>	F2
3Dパノラマ	<p>3DパノラマX線像はロードした3Dスキャンに基づいて作成されます。</p>	F3
歯	<p>特定の歯に移動し、SmartPanel™の [レイアウト] タブを使用してすべての2Dデータと3Dデータを比較します。選択した歯に注釈を付けます (37ページを参照)。</p> <p>垂直ビューアの垂直スライダーを使用すると、歯の回転軸を中心としてスライスが回転します。状況に応じて、次のスライスヒントがリスライスの方向を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 口腔側／頬側 (O/B) - 近心／遠心 (M/D) - 左／右 (L/R) <p>回転軸を調整するには、38ページを参照してください。</p> <p>エンドワークスペースに移動するには、もう一度 [F4] キーを押します (利用可能な場合)。</p>	F4

ワークスペース	説明	ショートカットキー
エンド	<p>歯内解析と歯内療法の対象となる歯に焦点を合わせます。歯髄を表示するには、[SmartPanel™ビューア] タブの [エンド] 3D可視化をクリックします。</p> <p>注記 このワークスペースは、3Dスキャンがロードされ、歯の注釈が定義されている場合に使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3Dビューアは、対象の歯に焦点を合わせています。 - 歯の断面ビューアは、歯の水平方向のいくつかの断面を表示する断面のビューアです。 - 歯根形態を定義すると (39ページを参照)、歯根管が表示されます。 <p>[歯] ワークスペースに移動するには、もう一度 [F4] キーを押します (利用可能な場合)。</p>	F4
インプラント	<p>インプラントを計画し、検査します。このワークスペースは、デフォルトで、OPGビューア、インプラントへのスナップビューア、および断面ビューアの3つのビューアで構成されています。</p> <p>OPGビューアで横断面リスライスをクリックしてドラッグし、目的の位置に移動します。</p>	F9
3D検査	歯の範囲外の特定のポイントに移動して検査します。	N/A
TMJ	顎頭と顎関節の領域を検査します。	N/A
デンタルスキャン	デンタルスキャンを検査して比較します。3D患者のワークスペースに移動するには、もう一度 [F2] キーを押します (利用可能な場合)。	F2
OPG	2DパノラマX線画像 (パノラマ) またはマルチレイヤーパン画像を表示します。	F5
口腔内	<p>レイアウト上の口腔内画像を検査します (例: フルマウスのX線像シリーズ)。</p> <p>画像をダブルクリックして、追加のワークスペース機能イメージフィルタとSmartLayoutを使用します (36ページを参照)。</p> <p>SmartPanel™の [レイアウト] タブの歯の範囲のサムネイルをクリックして別の画像に切り替えます。</p> <p>もしくは、← ↑ ↓ → 矢印キーを使用することもできます。</p> <p>最初のレイアウトの概要に戻るには、右上のレイアウトのタイトルをクリックするか、[Esc] キーを押します。</p>	F6

ワークスペース	説明	ショートカットキー
セファログラム	正面および／または側面のセファログラムを表示します。読み込まれた3Dスキャンに基づいてセファログラムを計算する、または2Dセファログラムをインポートするには、[3Dセファログラムを生成] ツールを使用します。	F7
臨床写真	患者の臨床写真を表示します。	F8
口腔内写真	臨床写真に似ていますが、口腔内カメラ画像が含まれています。歯式チャートで歯を選択し、口腔内カメラを使用して[歯]ワークスペースで画像を取得すると、取得した画像が、選択した歯に自動的に割り当てられ、割り当てられた歯番号が臨床写真ワークスペースに表示されます。	N/A
口腔内カメラ	口腔内カメラ取得専用のワークスペース。	F10
最近の画像	[最近の画像]ワークスペースには、最近インポートまたは取得したすべての画像が表示されます。デフォルトでは、ワークスペースには過去7日間の画像が表示されます。これを変更するには、患者モジュールのプリファレンスに移動します。	F12

ワークスペースのカスタマイズ

1. [プリファレンス]ウィンドウで、[ワークスペース]をクリックします。
2. [デフォルトワークスペース]リストで、患者モジュールを開いたときにデフォルトで表示するワークスペースを選択します。標準設定は[最新のデータ]で、最新の取得画像またはインポート画像に関連付けられたワークスペースが表示されます。
3. 必要に応じて、[最近の画像]ワークスペースに表示する画像について、[最近の画像]フィールドの日数を変更します。デフォルト値は7日です。
4. [OK]をクリックします。

SmartFocus™で関連する歯の情報をすべて表示

サポートされているビューアで、SmartFocusを有効にするには、スペースバーを押します。あるいは、上部メニューバーの ⊕ をクリックします。

- [歯]ワークスペースに移動し、オプションでビューアに特定の歯のデータをロードするには、歯の領域をクリックします。
- 歯の範囲外の領域をクリックして、[3D検査]ワークスペースに移動します。


スマートレイアウトでビューをカスタマイズ

ワークスペースのカスタマイズは、[SmartPanel™ レイアウト] タブを使用してビューアを追加または削除したり、ビューアの比率を変更したりして行います。

- ワークスペースに別のビューアを追加するには、[SmartPanel™ レイアウト] タブでタイルをクリックします。
- ワークスペースからビューアを削除するには、そのタイルを再度クリックします。
- ビューアの比率を変更するには、ウィンドウプリッターのいずれかをドラッグします。
- ビューアを閉じるには、左上のウィンドウタイトルをクリックします。
[ビューアを閉じる] を選択します。あるいは、[Q] キーを押します。
- モダリティや日付でソートしたり、選択した画像が最初に表示されるようにするには、[ソート項目] ドロップダウンメニューをクリックして、[モダリティ]、[日付]、または [最初に選択済み] を選択します。
- ワークスペースのレイアウトを保存するには、ワークスペースのタイトルの横にある ... をクリックし、[ワークスペースのレイアウトの保存] を選択します。このレイアウトは、新規患者の解析のためのデフォルトのレイアウトとして設定されます。ビューアをリセットするには、[ワークスペースのリセット] をクリックします。

スマートフュージョンにおけるデンタルスキャンのアライメント

デンタルスキャンを3D患者ワークスペースの3Dスキャンとアライメントするには、次の手順に従います。

1. [3Dスキャン] ツールメニューの [デンタルスキャンのアライメント]  をクリックします。
2. デンタルスキャンを選択し、[次へ] をクリックします。
3. 必要に応じて、対応するポイントを指定し、[骨閾値] スライダーを使用して表示を調整します。
4. アライメントをチェックします。
5. [終了] をクリックします。




サムネイルバーの使用

口腔内ワークスペースと臨床写真ワークスペースの下部にあるサムネイルバーには、解析に追加されていてもワークスペースビューアには表示されていない画像がすべて表示されます。

- サムネイルバーから画像をドラッグし、プレースホルダの上に画像をドロップします。
- プレースホルダに既に画像が含まれている場合は、その画像が新しい画像に置き換えられ、古い画像はサムネイルバーに再び追加されます。

解析所見の追加

[SmartPanel™ 結果] タブでは、歯の病変、顎関節の問題、または歯に関するその他の所見を記録できます。

- 事前に定義された所見を歯に追加するには、[診断] ツールメニューまたは [SmartPanel™ 所見] タブで [所見の追加]  をクリックします。所見を選択します。必要に応じて、所見の [スクリーンショット]  をクリックして、スクリーンショットを含めることができます。
- 所見を削除するには、所見の上にカーソルを置くか、所見を選択し、 をクリックして [削除] を選択します。
- カスタムの解析所見を追加するには、検索フィールドにカスタムの所見テキストを入力し、[Enter] キーを押すか [追加] をクリックします。
- 必要に応じて、ドロップダウンメニューをクリックしてステータスを割り当てます。

備考


歯のワークスペースでは、ステータスは歯式チャートにも視覚的に示されます。

歯のワークスペースで所見を追加した場合、その所見は特定の歯に追加されます。

別のワークスペースで所見を作成した場合は、歯番号のプレースホルダをクリックし、歯番号を入力して、特定の歯に所見を割り当てます。

SmartPanel™ 歯式チャート

歯のワークスペースとエンドワークスペースでは、歯式チャートは [SmartPanel™] タブの上に表示されます。



- データがワークスペースに表示されている有効な歯は緑色で強調表示されます。
- 歯式チャートで歯をクリックして、別の歯を選択します。
- 前の歯に移動するには、歯式チャートの下の < をクリックし、次の歯に移動する場合は > をクリックします。
- 少なくとも1つの所見が追加されている歯は、その輪郭が色付きで示されます。色は、所見の治療ステータスによって異なります。

治療ステータス	色	説明
状態	灰色	この所見は重大ではありませんが、時間の経過に伴う変化を注意深く観察する必要があります。
治療計画	赤	治療を必要とする所見です。
経過観察	オレンジ	初期段階で発見された所見であり、経過観察が必要です。
完了済み	青色	この所見の治療は完了しました。

歯のワークスペースでの歯の回転軸の調整

1. [軸を編集] (🔧) をクリックするか、[A] キーを押します。
2. オレンジ色の十字形が、垂直および平行のビューアの上部に描画されます。
3. ビューア内でマウスをドラッグして、ビューアを中心点を中心に画像データを回転させます。
4. もう一度[A] キーを押すか、右クリックして、このアクションを終了します。

3Dボリュームのクリッピング

SmartPanel™の[3D患者]、[歯] および [3D検査] のワークスペースの[ビューア] タブで、[3D表示のクリップ] を選択し、3Dボリュームの一部を非表示にして、そのボリュームの特定の領域を検査します。

ワークスペースでの歯科用口腔内カメラの使用

USB歯科用口腔内カメラを口腔内カメラのワークスペース内で直接使用するか、または別のワークスペース内から使用して、口腔内画像を取得します。

1. [口腔内カメラ] ワークスペースタブをクリックするか、任意のワークスペースで[SmartPanel™ カメラ] タブをクリックします。
2. 必要に応じて、カメラ機器のタイルをクリックします。
3. 機器のボタンをクリックして、画像を取得します。あるいは、下部にある[画像キャプチャ] をクリックします。

ツール

ツールバーには、解析、測定、治療の計画、スキャンデータの編集を行うためのツールがあります。

一部のワークスペースでは、特定のツールを使用できない場合があります。使用できないツールはグレー表示になっています。



警告

測定値の精度は、画像データ、使用されるスキャナー、キャリブレーションおよび取得設定によって異なります。測定値の精度は、画像の解像度より高くなることはありません。DTX Studio™ Clinicソフトウェアは、ユーザーが選択した小数点の桁下で四捨五入した値を報告します。

ツールバーのタブの1つをクリックすると、対応するツールに移動します。

[解析] タブ



3Dリスライスビューアのスライスの厚さを設定します。3Dリスライスビューアをクリックして水平方向にドラッグし、X線の厚さを設定します。右クリックして終了します。

注記

デフォルトのスライスの厚さを設定するには、DTX Studio™ Clinicの設定の[画像設定]タブに移動します。右上のドロップダウンメニューで、[3Dリスライス]、[パノラマ]、または[歯]を選択します。[スライスの厚さ]ドロップダウンメニューで目的の厚さを選択します。



明るさとコントラストを調整するには、次のようにビューアをドラッグします。

- 水平方向: 対比を変更します。
- 垂直方向: 明るさを変更します。

注記

明るさと対比のツールをグレースケール画像で使用すると、それに応じてレベルとウィンドウの値が更新されます。



画像の特定の領域を拡大するか(デフォルト設定)、適用されたフィルタと元の画像を比較します。拡大レベルを調整するには、マイナスキーとプラスキー(macOSを使用する場合はShift + プラスキー)を使用します。デフォルト設定を変更するには、患者モジュールのプリファレンスに移動します。



3Dモデルをクリックするとき、ベースになるリスライスを調べます。

- リスライスは、オーバーレイスライスのエクスプローラウィンドウに表示されます。
- アクティブなイメージフィルタとスライスの厚さは、スライスのエクスプローラービューにも適用されます。
- スクロールして、すべてのリスライスを確認します。
- 3Dモデルは、ベースとなるリスライスを検査している間も回転可能です。




スクリーンショットをキャプチャします。このスクリーンショットは、臨床写真のワークスペース、SmartPanel™の[レイアウト]タブおよび患者データに追加されます。キャプチャされたスクリーンショットはレポートに追加できます(37ページを参照)。




SmartPanel™の[所見]タブに所見を追加します。

[解析] タブ


-
- 

気道を解析します。ランドマークを指定して、関心領域を囲むボックスを作成します。[終了]をクリックします。気道の容積と最も狭窄している領域は、[3D患者]ワークスペースで視覚化されます。

 - 


神経を指定します。最初のアンカーポイントをクリックします。それぞれの次のアンカーポイントをクリックします。右クリックして終了します。

 - ビューアのアンカーポイントを移動して、神経注釈を調整します。
 - すべてのアンカーポイントは、SmartPanel™の[注釈]タブに1本の線として表示されます。

 - 

3D患者ワークスペース(コロナル/サジタル/アキシャル)の任意のスライスビューアでカスタムのスライス線を描画して、(CB)CTデータを詳細に検査するカスタムのスライスを作成します。たとえば、根管にマークを付けて検査したり、注釈を付けたりします。


 - スライスラインをクリックしながらドラッグすることで、カスタムのスライスを移動します。
 - スライス線の末端の1つをクリックしながらドラッグすることで、カスタムのスライスを回転させます。

 - 


各歯根管に根尖の基準点を指定することで、**歯根形態**を定義します。

 1. スライスをスクロールして、最適な位置を見つけます。
注記
 必要に応じて、[水平]ビューアで中心をクリックしながらドラッグすることで歯の中心を再指定します。
 2. ビューアの1つで位置をクリックします。
 3. 根管の視覚化はすぐに[歯根管]ビューアに表示されます。
 4. 必要に応じて、[ポイントを追加]をクリックして新しい基準点を追加します。
 5. [終了]をクリックします。


[注釈] タブ

-
- 


画像にテキストを追加します。

 - 


ペンで、折れ線を描画します。すべての線は、SmartPanel™の[注釈]タブに1つの注釈として表示されます。

 - 


鉛筆でフリーフォームの線を描画します。

 - 

円を描きます。

 - 

矢印を描きます。

 - 

注釈の線の太さを選択します。

[測定] タブ

- ✂
ある点のHU値を測定します。シーンの任意の点をクリックしてHU値またはグレー値を測定します。
- 📏
直線距離を測定します。距離を測定する2つの点をクリックします。画像のキャリブレーションがまだ済んでいない場合は、まず[参照値]を入力します。キャリブレーションの計測値がシーンに表示され、キャリブレーションオブジェクトが、SmartPanel™の[注釈]タブに追加されます。
測定(およびその精度)が表示されます。
- 📐
セグメントを測定します。最初のポイントをクリックします。それぞれの次のポイントをクリックします。右クリックして終了します。
- 📐
角度を測定します。3つの点をクリックします。








[インプラント] タブ

- 📄
インプラントを配置します。このツールは、CBCTデータを含む任意のワークスペースで使用できます。
- 🗑
どのインプラントが配置可能かを管理します。




[3Dスキャン] タブ

- 🧠
MagicDetectは、CB(CT)データと下顎神経に注釈を自動的に設定するために使用されるAIを利用したアルゴリズムです。自動検出されたすべてのポイントは手動で調整できます。
自動的に検出された属性を含む3Dスキャンは、右下隅に[自動]ラベルで示されます。
- 🧠
患者モデルの方向を編集します。3D患者モデルの方向は、3Dビューアでモデルを平行移動して回転することによって目的の位置に設定することができます。
 1. 移動アイコン または回転アイコン をクリックするか、[Tab]キーを押して回転と平行移動モードを切り替えます。選択されているモードは緑色で表示されます。
 2. 基準線と正しく位置合わせされるまでモデルをドラッグします。
 3. [終了]をクリックします。

[3Dスキャン]タブ

-
-  OPG曲線を調整します。必要に応じて、ポイントや歯を指定します。歯がはっきり表示されない場合は、スクロールするか、右側のグレーのスライダーを使用して、仮想歯のセットアップを示す平面に軸方向リスライスの位置を合わせます(だいたい咬合面に収束します)。
- 必要に応じて、曲線を調整します。
- 曲線の形状を調整するには、個々のコントロールポイントをクリックしながらドラッグします。
 - 新しいコントロールポイントを追加するには、曲線をクリックします。
 - 完成した曲線を移動するには、周辺領域をクリックしてドラッグします。
-
-  TMJ領域を指定します。ウィザードに示されているように、顎頭の位置を示します。[終了]をクリックします。TMJワークスペースが開き、ここで左右の顎頭の位置を比較して、顎関節領域を検査します。
-
-  歯の位置を指定します。歯式チャートで、キャリブレーションする歯を選択します。軸方向リスライスの正しい位置に歯のインジケータをドラッグします。垂直リスライス上で、歯の軸を調整します。
-
-  骨閾値を調整します。3Dビューアで水平方向にクリックしながらドラッグし、骨閾値を調整します。
-
-  患者モデルの余分な部分を切り取って、クリーンアップします。シーン内のポイントをクリックして、削除する必要のあるセクションの周囲の描画を開始します。右クリックして確認します。
- 注記**
元の患者モデルを復元するには、SmartPanel™の[ビューア]タブの[3D可視化]の横にある ... をクリックします。[3Dモデルのリセット]を選択します。
-
-  OPGを生成します。パノラマ(リスライス)ビューは、2D画像として患者データに追加されます。生成された画像はOPGワークスペースで開かれます。
-
-  インポートした3Dスキャンに基づいて、3Dセファログラムを生成します。
-

[デンタルスキャン]タブ

-
-  デンタルスキャンの向きを自動的に設定します。
-
-  SmartFusion™で、デンタルスキャンを3Dスキャンとアライメントまたは再アライメントします。
-
-  デンタルスキャンワークスペースに現在表示されているすべての顎スキャンと診断スキャンの穴*を埋めます。小さい穴またはすべての穴を選択して埋めます。[穴を埋める]をクリックします。追加されたテクスチャは青色で示されます。

* Windowsのみ。

[デンタルスキャン]タブ



デンタルスキャンを比較して、歯肉退縮、歯の摩耗、その他の違いを経過観察します。参照スキャンと比較する、デンタルスキャンを選択します。[終了]をクリックします。

デフォルトでは、色付き距離マップが適用されます。2つのスキャンを並べて表示するには、SmartPanel™の[ビューア]タブで、[オーバーレイ]を選択します。比較を無効にするには、[スキャンの比較]オプションをオフにします。



SmartSetupを使用して仮想歯を計算します。

レポート

レポートの作成

所見を含むレポート、または患者に関連する文書のテンプレートとしてのレポートを作成するには、次の手順に従います。

1. 患者モジュールで、患者メニューを開きます。
2. [レポートのエクスポート]をクリックします。
3. レポートテンプレートを選択します。
4. [レポートのエクスポート]をクリックします。
5. レポートは編集可能な.odt形式でエクスポートされ、デフォルトのテキストエディタ (Microsoft Office、LibreOffice、OpenOffice Writerなど) で開くことができます。
6. 必要に応じて変更を加えます。
7. レポートを保存します。

カスタムのプラクティスロゴの追加

デフォルトでは、DTX Studio™ Clinicのアイコンがレポートのヘッダーに追加されます。カスタムのロゴを追加するには、次の手順に従います。

1. [設定](#)のサイドバーで[レポート]をクリックします。
2. [参照]をクリックします。
3. 新しいロゴを選択します。
4. [OK]をクリックします。

DTX Studio Implantの起動

DTX Studio™ ClinicとDTX Studio Implantの接続

1. [メニュー]をクリックします。
2. [設定]をクリックします。
3. [DTX Studio Implant]をクリックします。
4. [参照]をクリックして、コンピュータ上のDTX Studio Implantのインストール場所に移動します。

注記

患者データをDTX Studio Implantの患者記録に手動で追加する必要がある場合、つまり患者記録が既にDTX Studio Implantに存在している場合、または口腔内スキャンがDTX Studio Implantにエクスポートされているが3Dスキャンとアライメントされていない場合は、患者データの保存先を設定します。


5. [OK]をクリックします。

DTX Studio Implantの起動

1. 患者リストで患者記録を選択します。





注記

この患者に対して1つ以上の3Dスキャンが利用可能である必要があります。

2. [インプラント]  をクリックします。
3. [既存の患者を開く] または [新しい患者にエクスポート] を選択します。
4. 3Dスキャンが複数ある場合は、適切なタイルを選択します。
5. [エクスポート] をクリックします。
6. 正常に完了したことを示すメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
7. 患者記録が作成され、DTX Studio Implantに表示されます。

オーダー

補綴修復または手術計画のオーダー

1. 患者リストで患者記録を選択します。
2. [オーダー]  をクリックします。
3. [補綴修復]  / [手術計画]  を選択します。
4. 患者データを選択して、ラボまたは歯科医師に送信します。
5. [続ける] をクリックします。
6. オーダーのドラフトがDTX Studio Goに作成されます。不足データを追加し、接続されたラボまたは歯科医師にオーダーを送信します。
7. サイドバーの[オーダー]  をクリックすると、すべてのオーダーが表示されます。

注記

本取扱説明書で言及している製品のうち、国や地域によっては一部の製品が未認可、未販売、または未承諾の場合があります。ご了承ください。



Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Sweden

www.nobelbiocare.com

オーストラリアの配布元:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Australia

電話: +61 1800 804 597


ニュージーランドの配布元:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
New Zealand

電話: +64 0800 441 657

トルコの配布元:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No:10/7
Beşiktaş İSTANBUL
電話: +90 2123614901



スイスの輸入業者/スイスの正規代理店:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Switzerland



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com